



MANDATO DE PARTICIPAÇÃO E COMPROMETIMENTO

Ao
Exmo. Sr.
Romario Paz
Pres. da Câmara de Vereadores
Santana do Livramento – RS

EMENDAS IMPOSITIVAS

Conforme Check List solicitado pelo Executivo Municipal para readequações das Emendas Impositivas, e embasado no Art.120-A da Lei Orgânica Municipal segue abaixo resposta do referido documento para posterior análise:

EMENDA DE PROTOCOLO 3695

O Recurso para redução é o da **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**
28.846.999- Reserva de Contingência
28.846.9999.999 Reserva de Contingências

EMENDA DE PROTOCOLO 3696

Quantidade e especificação necessária de materiais de consumo:

50.000 folders

Formato A4 (29,7 cm de largura x 21 cm de altura)

Conforme figura em anexo

Full color couchê 120 g

O Recurso para redução é o da **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

28.846.999- Reserva de Contingência

28.846.9999.999 Reserva de Contingências

EMENDA DE PROTOCOLO 3697

Quantidade e especificação necessária de materiais de consumo:

30.000 folders

Formato A4 (29,7 cm de largura x 21 cm de altura)

Full color couchê 120 g

Conforme figura em anexo

O Recurso para redução é o da **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

28.846.999- Reserva de Contingência

28.846.9999.999 Reserva de Contingências

EMENDA DE PROTOCOLO 3698

Quantidade e especificação necessária de materiais de consumo:

50.000 folders

Formato A4 (29,7 cm de largura x 21 cm de altura)

Conforme figura em anexo

Full color couchê 120 g

O Recurso para redução é o da **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

28.846.999- Reserva de Contingência

28.846.9999.999 Reserva de Contingências

EMENDA DE PROTOCOLO 3704

Quantidade e especificação necessária de materiais de equipamento:

Quantidade : 1

Especificações do Equipamento:

Método de medição: Medição da condutividade elétrica (C. E.)

Cálculo: Diferença da condutividade elétrica calculada por computador.

Calibração automática.

Que contenha:

1. Display digital de três dígitos
2. Display que contemple os valores absolutos de todos os tetos.
3. Display que indique a diferença da condutividade elétrica após o cálculo.
4. Display que indique a condutividade elétrica calibrada.
5. Display que indique a Faixa de medição: 0 a 13 mS/cm (miliSiemens por centímetro)

Precisão: 3% +ou- 1 dígito

Compensação automática de temperatura: +3 a 40°C (compensado para +25°C)

Alimentação: 2 pilhas AA

Consumo: 0.45 mA v Dimensões: 91 (largura) x 45 (altura) x 181mm (comprimento)

Peso líquido: que tenha aproximadamente 320g

Cópia de orçamento para indicação do valor do produto:
Em anexo

Mesmo a Emenda Constitucional nº 86/2015, que enfatiza que a função legislativa das Câmaras Municipais passa a gozar de novas ferramentas para auxiliar na organização orçamentária e para subsidiar a construção do planejamento estratégico do Município, as emendas impositivas são instrumentos pelo qual os vereadores podem apresentar à Lei Orçamentária Anual (LOA) destinando recursos do Município para determinadas obras, projetos ou instituições.


O valor das emendas é retirado de uma porcentagem do Orçamento Municipal e deve ser dividido igualmente entre os vereadores, cabe salientar portanto que os orçamentos solicitados pelo Executivo, conforme ofício 039/2020, devem apenas embasar o valor do objeto a ser licitado, não podendo ser utilizados como base do processo licitatório, que deve cumprir com as normas legais e se ater a Lei das Licitações 8666/93, principalmente para que sejam cumpridos os princípios fundamentais que regem essa lei e em face à autonomia do Executivo assegurada pela Constituição Federal. Todos os entes federativos, União, Estados, Municípios e Distrito Federal, são obrigados a licitar. Porém cada um possui sua própria competência para legislar, decorrente de sua autonomia política e administrativa.

O Recurso para redução é o da **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**





28.846.999- Reserva de Contingência

28.846.9999.999 Reserva de Contingências





Sant'Ana do Livramento, 02 de março de 2020.

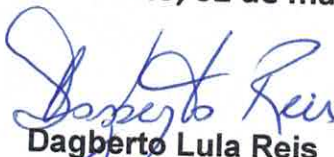
Dagberto Lula Reis
Vereador da Bancada do PT

A4
297mm

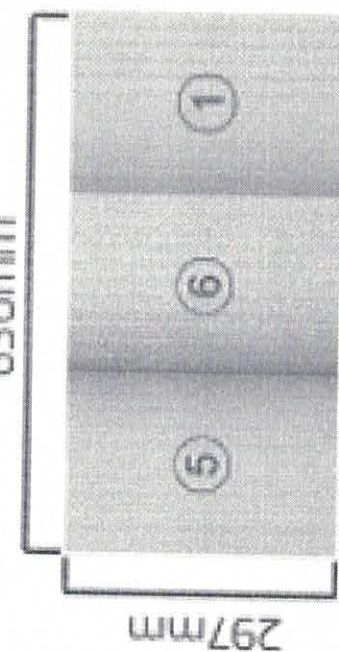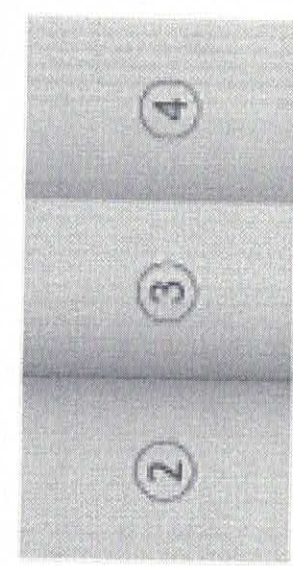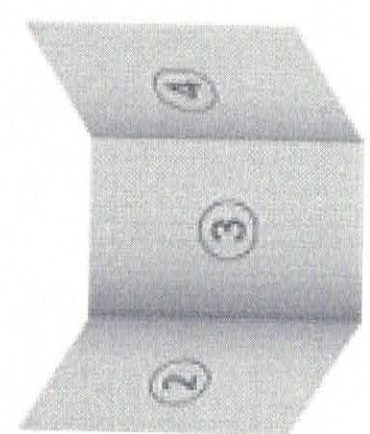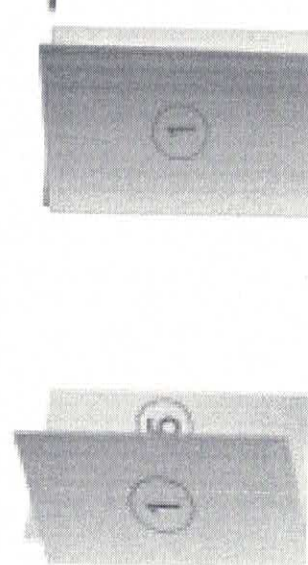

210mm

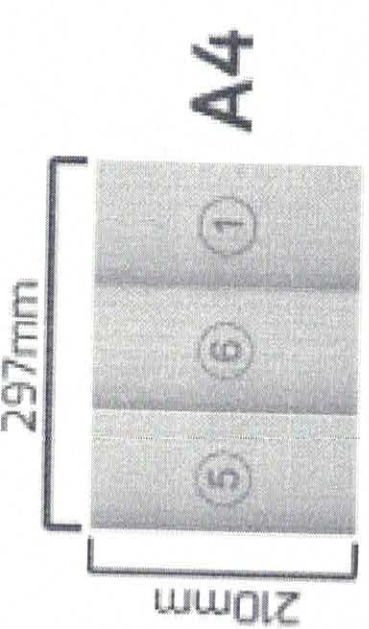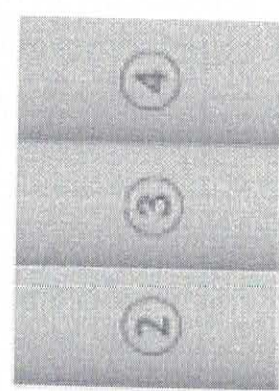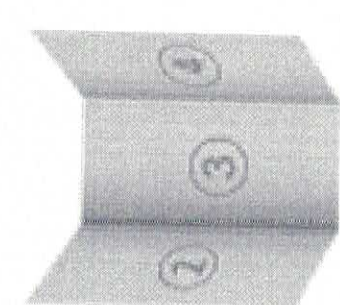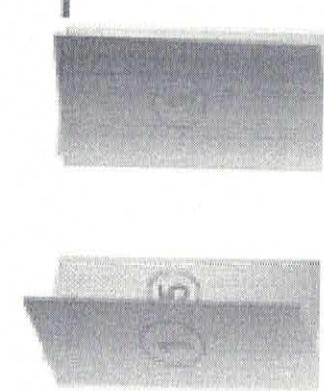



Produtos

Equipamento Analítico

Analísadores de leite

Analísador de leite portátil para

detecção de mastite bovina HyServe Milk Checker N-4L



Analísador de leite portátil para detecção de mastite bovina HyServe Milk Checker N-4L

Referência: N4L

Condição: Novo produto

Detecte a mastite clínica e confirme a pureza do leite do gado e rebanho!

Milk Checker – a mais recente inovação na detecção da mastite bovina que possibilita o diagnóstico preciso da mastite sub clínica.

Rápido e fiável

Em poucos segundos, obtenha os resultados da medição de pureza do leite, assim poderá controlar a saúde do seu rebanho, garantindo uma maior produção de leite de qualidade.

499,00€ sem IVA

Quantidade[Mais informação](#)[Avaliações](#)[1 outro produto na mesma categoria:](#)[Especificação Técnica](#)[Descarregar](#)

Características principais:

- O Milk Checker é extremamente útil para os produtores de leite. O leite contaminado causado pela mastite pode ser detectado com precisão com o N-4L.
- Fácil e simples de utilizar e os resultados podem ser rapidamente analisados.
- Pelo novo método de diagnóstico diferente do método convencional, o leite contaminado pode detectar-se no primeiro momento.
- Os resultados da detecção são exibidos para todos os quartos do úbere ao mesmo tempo. Os resultados da diferença entre os quartos do úbere também podem ser exibidos.

Reduza os custos de tratamento e poupe dinheiro!

A mastite bovina é um processo inflamatório que atinge a glândula mamária das vacas, de caráter contagioso e de fácil transmissão. Utilize o Milk Checker para detecção de mastite clínica. Com este equipamento consegue identificar a mastite no seu estado inicial, mesmo quando não são visíveis sintomas. Desta forma evita custos relacionados com tratamentos, de forma preventiva.

O que é o Milk Checker?

O Milk Checker é um medidor digital que detecta mastite nos bovinos com elevada precisão.

Vantagens

- **Rápido e fiável**
 - Com o Milk Checker, bastam alguns segundos para se detectar a mastite sub clínica no animal. O Milk Checker analisa as amostras de leite dos 4 quartos do úbere e mostra todos os resultados de uma só vez. Além disso, graças à uma tecnologia inovadora, o Milk Checker é mais fiável que os outros métodos de detecção de mastite.
 - Os resultados são exibidos numericamente num visor digital, com precisão decimal.
- **Monitoriza a saúde do seu rebanho**
 - O Milk Checker é um medidor importante para o seu negócio.
 - Utilizando o Milk Checker regularmente durante o período de lactação, pode identificar os bovinos infectados facilmente e separá-los dos animais sadios. Além disso, o equipamento também pode ser usado para verificar a eficácia do tratamento com antibióticos.
- **Previne surtos de mastite clínica**
 - Não deixe que o animal desenvolva a mastite clínica! Todos os anos, a mastite causa enormes prejuízos para os produtores de leite. Por isso, detectar é fundamental. Com o Milk Checker detecta-se a infecção no estágio inicial, quando ainda é invisível. Assim, evita os altos custos com o tratamento veterinário, antibióticos.

Como analisar os resultados

Os critérios usados pelo Milk Checker para avaliar o leite:

	ABS Conductividade Eléctrica (mS/cm)	DIF Diferença (mS/cm)
Leite normal	<6,2	<0,5
Leite anómalo	≥6.2	<0,5
Leite contaminado (Mastite)	<6,2	≥0,5
Leite contaminado (Mastite)	≥6.2	≥0,5

Qualidade testada e aprovada no Japão

O Milk Checker é um produto homologado pelo Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca do Japão, cujos critérios para a aprovação de equipamentos veterinários equivalente ao que a FDA utiliza para a aprovação de equipamentos médicos e hospitalares.

Como funciona o Milk Checker?

O Milk Checker está equipado com tecnologia mais inovadora, com a qual é possível verificar o mais pequeno desvio na condutividade eléctrica do leite.

No caso de uma inflamação das glândulas mamárias (mastite), os componentes do plasma do sangue vão parar ao leite, aumentando aí a concentração de sódio e cloro, o que causa um aumento da condutividade eléctrica. Esta anomalia é detectada pelo Milk Checker, visto que uma mastite sub-clínica não se desenvolve simultaneamente nas quatro glândulas mamárias, o Milk Checker calcula automaticamente a diferença entre os valores de medição de todas as glândulas mamárias e identifica assim aquela que poderá ter mastite.

 **PayPal** Check out

The safer, easier way to pay

Informação da Loja

 HACPEMI, LDA, Rua Jose Carvalho Araujo, 236, Edifício Regata 2750-396 Cascais PORTUGAL

 Ligue-nos agora: +351 217 655 520

 Email: emi@hacpemi.com

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
28.846.00.4161	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.846.00.4162	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
0001	LIVRE	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
28.846.00.4163	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
0001	LIVRE	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
28.846.00.4164	ENCARGOS GERAIS ESPECIAIS	4.462.000,00	0,00	0,00	4.462.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0001	LIVRE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.780.000,00	0,00	0,00	2.780.000,00
0001	LIVRE	2.780.000,00	0,00	0,00	2.780.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
0001	LIVRE	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
28.846.00.4403	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS S/RCL	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
0001	LIVRE	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.998.000,00	0,00	4.998.000,00
28.846.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00	4.998.000,00	0,00	4.998.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00	(R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	0,00	4.998.000,00	0,00	4.998.000,00
0001	LIVRE	0,00	4.998.000,00	0,00	4.998.000,00
TOTAL GERAL		171.292.110,00	59.534.718,00	0,00	230.826.828,00

BUSCAR

Qualidade
que se
Mede

Entre ou cadastre-se
Meus pedidos


CONTROLE DE QUALIDADE ANÁLISE DE ÁGUA LABORATÓRIO SEG. DO TRABALHO MECÂNICA COMBOS ACESSÓRIOS CALIBRAÇÃO

Você está em: [Página inicial](#) > [Laboratório](#) > [Analisadores de Leite](#) > [Analisador de Leite Master Mini](#)

Analisador de Leite Master Mini

[Ver descrição completa](#)

Indique este produto para um



MANUAL
(PDF)

VEJA O VÍDEO




FRETE GRÁTIS

R\$ 4.973,68

ou até 7x de R\$ 710,53 sem juros

Calcule o frete:



CALCULAR

ADICIONAR AO

Analisador de Leite Master Mini

R\$ 4.973,68

em até 7x de: R\$ 710,53 sem juros

COMPRAR

PRODUTOS RELACIONADOS




Solução de Limpeza Alcalina para Analisador de Leite (120g)

R\$ 40,95



Solução de Limpeza Ácida para Analisador de Leite (120g)

R\$ 42,90

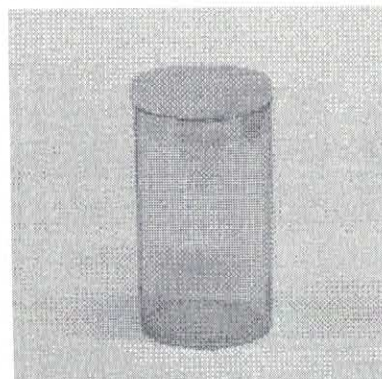

Cubeta Plástica com Tampa para Master Mini (23ml)

R\$ 4,94



FRETE GRÁTIS

Impressora Master Mini Resulta

R\$ 1.42

em até 7x de

DESCRIÇÃO

É de grande importância a análise das amostras de leite, pois com os dados coletados é possível identificar problemas no processo de produção leiteira e também detectar possíveis fraudes no leite após comercialização para empresas do setor lácteo.

Quando falamos nesse assunto, precisamos pensar na praticidade e o analisador de leite Master Mini possui essa característica. Compacto, esse modelo realiza em apenas 60 segundos análises de gordura, desengordurado, densidade, proteínas, lactose, sólidos, água adicionada, ponto de congelamento e temperatura, em diversos tipos de leite.

Possui saída serial RS232 para comunicação com o PC, adaptador veicular de 12V que facilita a mobilidade do instrumento proporcionando medições a campo com muita agilidade.

Conta com entrada USB, que permite salvar os resultados em uma pen drive, tornando o armazenamento e gerenciamento dos resultados mais prático.

Pode ser utilizado tanto pelo produtor, para que ele tenha a comprovação de que entregou um produto de qualidade, quanto por laticínios, para o monitoramento de forma ágil dos padrões de qualidade.

Indicamos a aquisição da Impressora Master Mini, para que o usuário tenha a opção de imprimir as análises realizadas.



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



Download Software

Faixa de medição:

Gordura: 0 a 20%
Extrato seco desengordurado: 3 a 15%
Densidade: 1015 a 1040 kg/m³
Proteínas: 2 a 7%
Lactose: 0.01 a 6%
Água adicionada: 0 a 70%
Temperatura: 1 a 40°C
Ponto de congelamento: -0.3 a -0.7°C
Sólidos: 0.4 a 1.5%

Exatidão:

Gordura: $\pm 0.08\%$
Extrato seco desengordurado: $\pm 0.1\%$
Densidade: $\pm 0.3\text{kg/m}^3$
Proteínas: $\pm 0.1\%$
Lactose: $\pm 0.1\%$
Água adicionada: $\pm 3.0\%$
Temperatura: $\pm 1^\circ\text{C}$
Ponto de congelamento: $\pm 0.005^\circ\text{C}$
Sólidos: $\pm 0.05\%$

Dimensões: 50 x 140 x 180 mm

Peso: 1000g

Volume de leite por amostra: 20 mL

Temperatura de operação: -10 a 50°C

Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação)

Alimentação: 12VDC (acompanha adaptador externo bivolt)

Acessórios:

- 1 manual em português
- 1 cabo RS232
- 1 adaptador AC/DC (fonte de alimentação)
- 1 adaptador veicular 12V
- 1 sachê de solução alcalina para limpeza (DAILY)
- 1 sachê de solução ácida para limpeza (WEEKLY)
- 1 CD (software)
- 2 cubetas de plástico

Software compatível com Windows XP e 7

Analisador de Leite Master Mini

R\$ 4.973,68

em até 7x de: R\$ 710,53 sem juros

COMPRAR

 **TELEVENDAS:**

(11) 2373-0040 | (11) 2373-0043

 (11) 93008-9392

 VENDAS@LOJANETLAB.COM.BR

INSTITUCIONAL 



CROMATOGRAFIA



INOX & FERRAGENS



MODELOS ANATÔMICOS



VIDRARIAS



EQUIPAMENTOS



ACESSÓRIOS



PLÁSTICOS



REAGENTES E MEIOS



TERMÔMETROS



PORCELANAS



PAPEIS ESPECIAS

FRETE GRÁTIS*

SP - RJ - MG - PR - RS - MS - MA - PI

PARCELAMENTO


PAGUE EM ATÉ 6X SEM JUROS NO CARTÃO

COMPRE E RETIRE

DISPONIBILIZAMOS O PEDIDO NO MESMO DIA

Você está em: Página inicial > EQUIPAMENTOS > Analisador de Leite > ANALISADOR DE LEITE - Master Mini

ANALISADOR DE LEITE - MASTER MINI

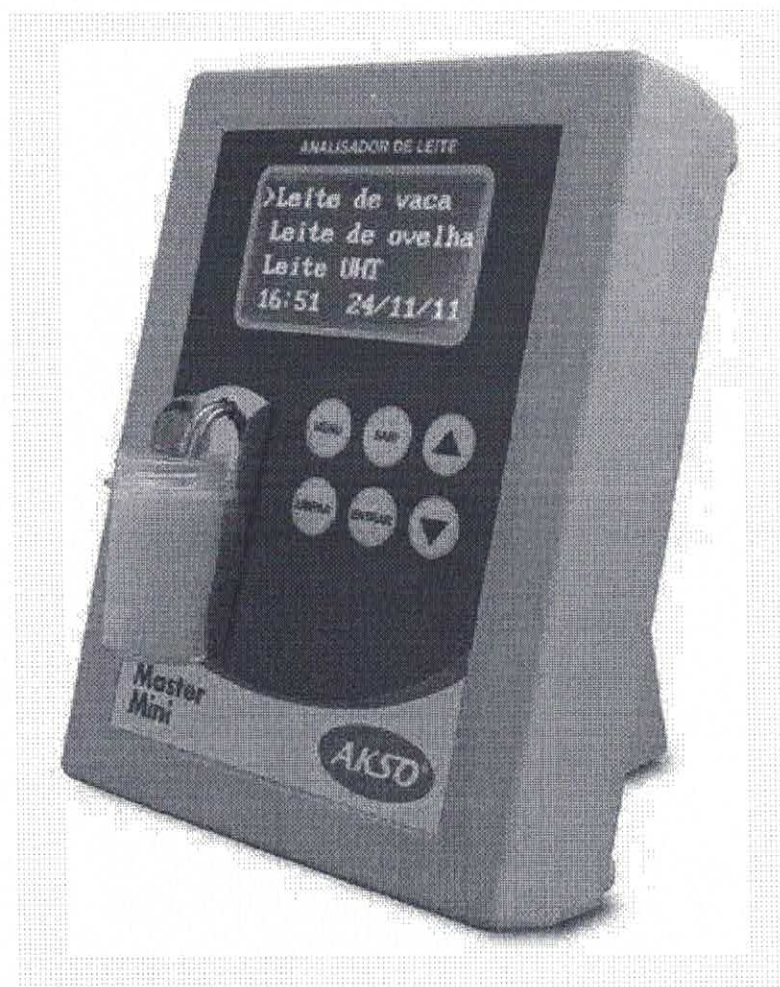

Indique a um amigo Tire suas Dúvidas

Modelo: **Master Mini**

Disponibilidade: **Disponível em 5 dias úteis**

Referência: **MASTERMINI**

Por: **R\$ 4.915,20**

ou 6x de **R\$ 819,20** Sem juros **R\$ 4.767,74** à vista com desconto Boleto -
Yapay

Digite seu CEP -

QUANTIDADE:

1



Colocar no
Carrinho

5 MOTIVOS PARA SER NOSSO CLIENTE !

- 1º MAIS DE 5 MIL PRODUTOS EM ESTOQUE, GARANTINDO RÁPIDA ENTREGA!
- 2º PREÇO JUSTO E PRODUTOS DE ALTA QUALIDADE!
- 3º PAGUE PARCELADO EM ATÉ 6X SEM JUROS OU BOLETO PARA PJ*
- 4º FRETE ÚNICO CONFORME O SEU ESTADO!
- 5º PÓS VENDA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE!

MYLABOR

Ficou com alguma duvida ou não encontrou o que precisa?



ENTRE EM CONTATO



(11) 2373-0040 | (11) 2373-0043



(11) 93008-9392



vendas@lojanetlab.com.br

DESCRIÇÃO GERAL

ITENS INCLUSOS

FORMAS DE PAGAMENTO

COMENTÁRIOS

Para os mais variados tipos de leite, realiza análises de gordura, extrato seco desengordurado, densidade, proteína, lactose, sólidos, água adicionada, ponto de congelamento e temperatura.

Possui saída serial RS232, adaptador veicular de 12V para medições em campo e sistema de limpeza automatizado.

A nova versão conta entrada USB, que permite salvar os resultados em uma *pen drive*, tornando o armazenamento dos resultados mais prático.



Download Software

Exatidão:

Gordura: $\pm 0.08\%$

Extrato seco desengordurado: $\pm 0.1\%$

Densidade: $\pm 0.3\text{kg/m}^3$

Proteínas: $\pm 0.1\%$

Lactose: $\pm 0.1\%$

Lactose: $\pm 0.1\%$

Água adicionada: $\pm 3.0\%$

Temperatura: $\pm 1^\circ\text{C}$

Ponto de congelamento: $\pm 0.005^\circ\text{C}$

Sólidos: $\pm 0.05\%$

Faixa de medição:

Gordura: 0 a 20%

Extrato seco desengordurado: 3 a 15%

Densidade: 1015 a 1040 kg/m³

Proteínas: 2 a 7%

Lactose: 0.01 a 6%

Água adicionada: 0 a 70%

Temperatura: 1 a 40°C

Ponto de congelamento: -0.3 a -0.7°C

Sólidos: 0.4 a 1.5%

Dimensões: 50 x 140 x 180 mm

Peso: 1000g

Volume de leite por amostra: 20 mL

Temperatura de operação: -10 a 50°C

Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação)

Alimentação: 12VDC (acompanha adaptador externo bivolt)

Acessórios:

- 1 manual em português
- 1 cabo RS232
- 1 adaptador AC/DC (fonte de alimentação)
- 1 adaptador veicular 12V
- 1 sachê de solução alcalina para limpeza (DAILY)
- 1 sachê de solução ácida para limpeza (WEEKLY)
- 1 CD (software)
- 2 cubetas de plástico

Software compatível com Windows XP e 7